


콘택트렌즈 도수 계산기 사용 방법

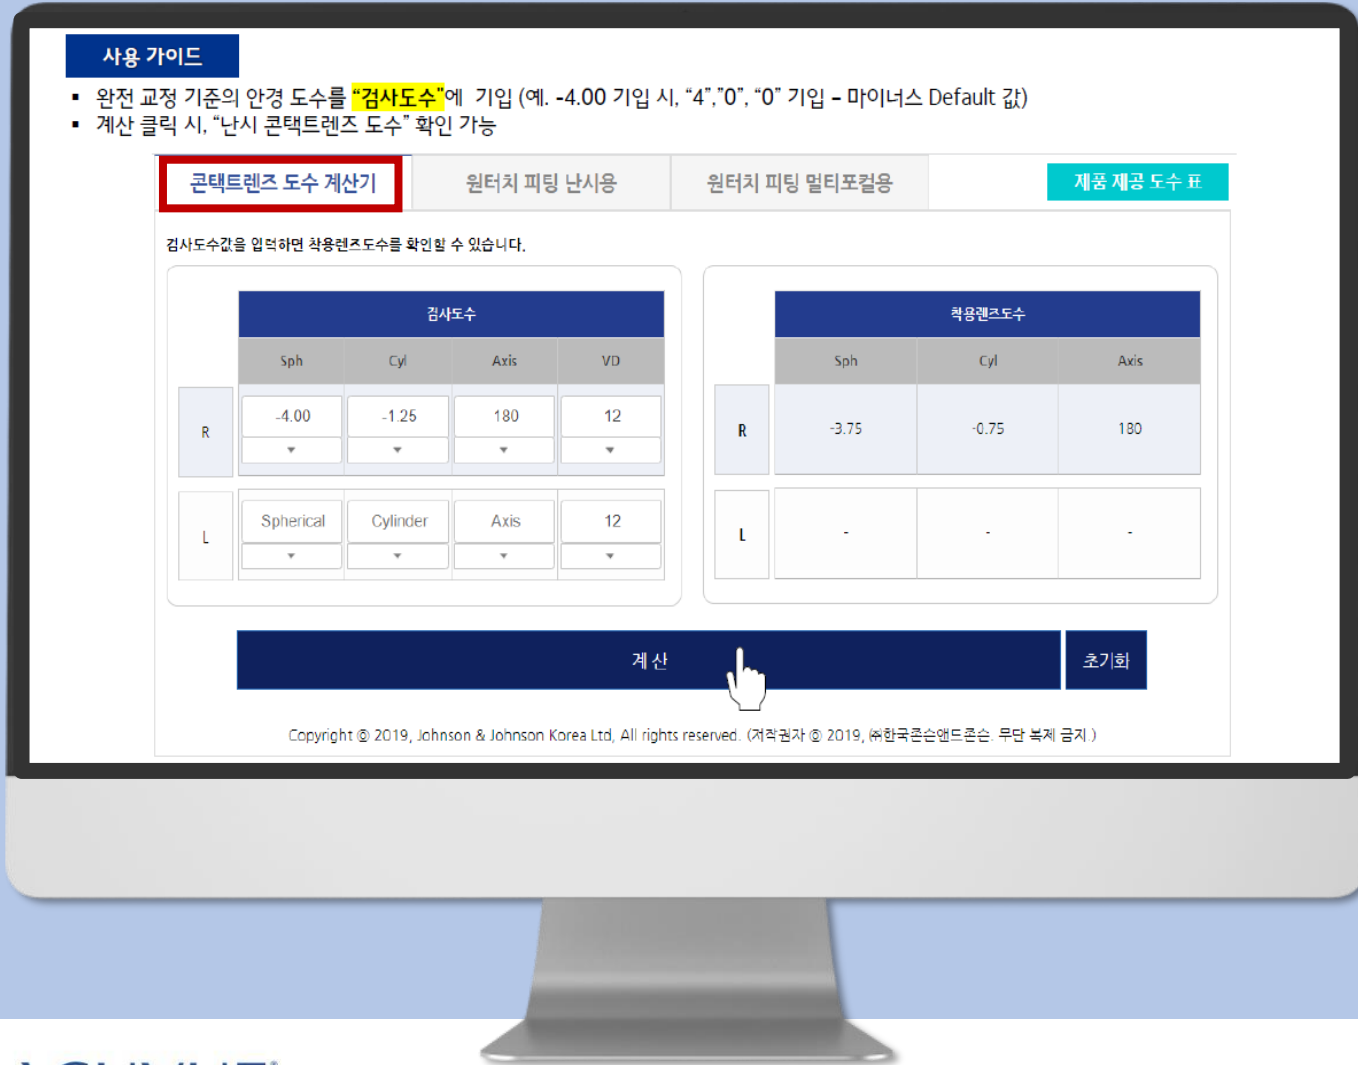

1단계

완전 교정 도수를 “검사도수”에 입력

**근시 도수 입력 시 (-)생략
(예, -5.00 기입 시, “5”, “0”, “0” 입력)
원시 도수 입력 시 (+) 입력

2단계

계산 클릭

3단계

정간거리 보정된 난시 콘택트렌즈 도수 확인 가능